



房间号：703 负责人：潘峰

703实验室

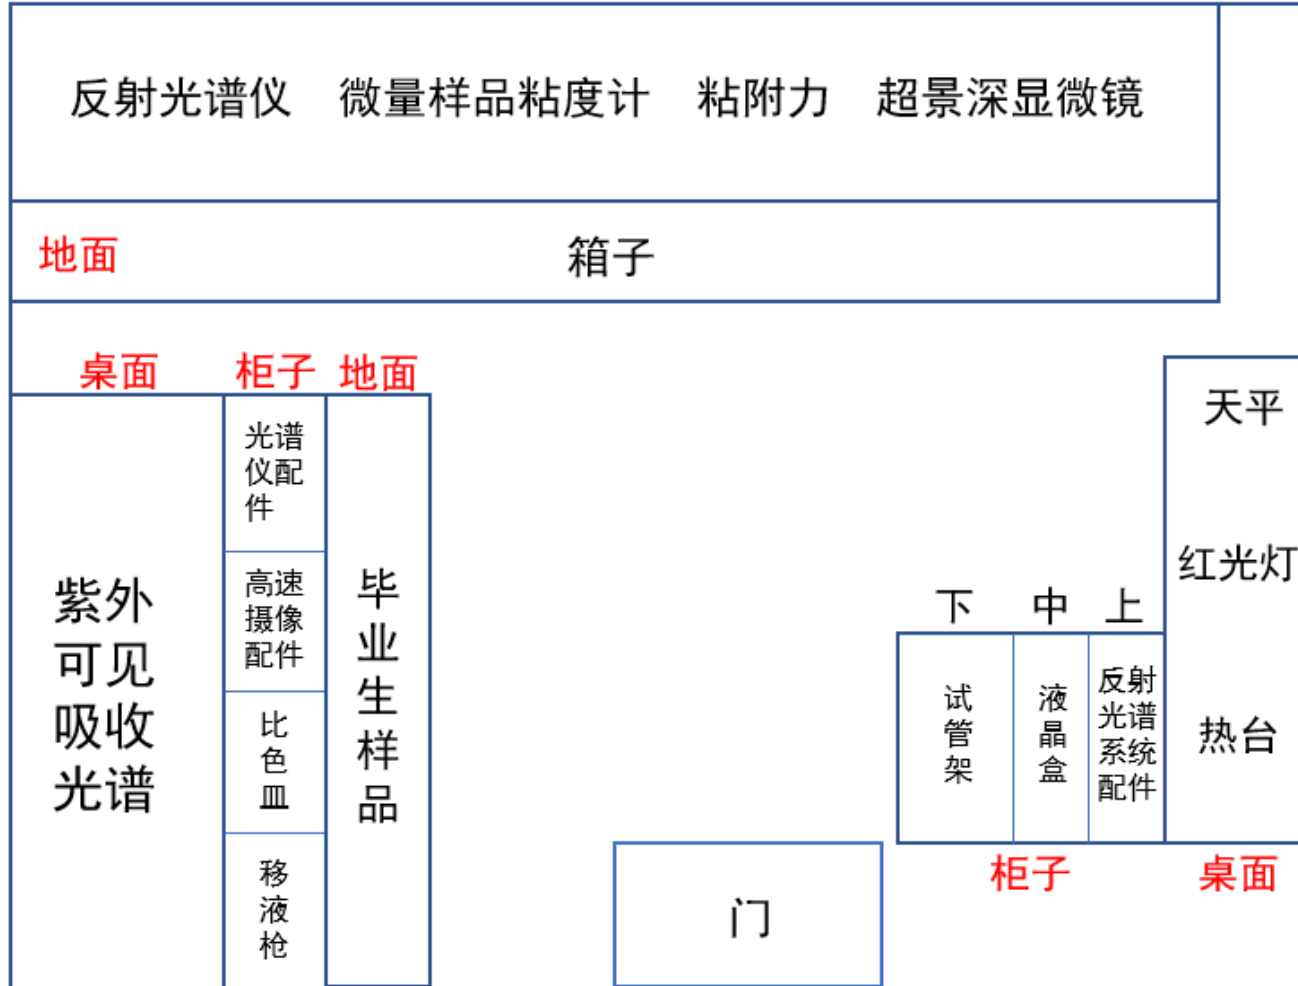

房间号：721 负责人：陈燕 孙浩哲 朱泽坤 刘大帅 刘雨

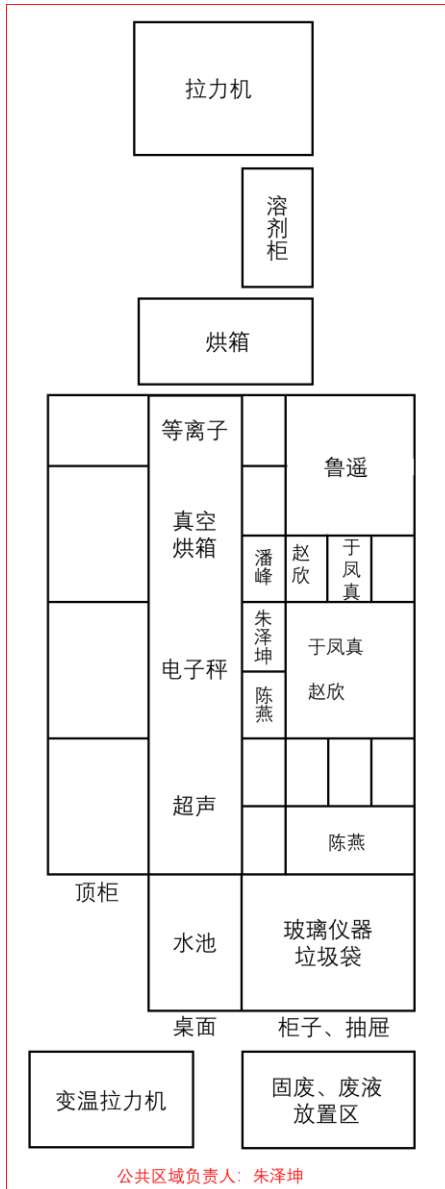

柜子	通风橱	通风橱	柜子
硅胶柱	旋蒸仪	过柱机	吉波
王金雷			刘雨
潘峰	过柱机	油浴锅	孙雪洁
汤彦甫			黄鑫
朱泽坤	双排管	双排管	冯瑶菁 姜黎新
陈燕			刘大帅
孙浩哲	油浴锅	旋蒸仪	张霄羽
鲁遥			张梦涵
彭博			
气瓶柜			


通风橱负责人：孙浩哲；通风橱负责人：陈燕



房间号：722 负责人：王金雷 孙雪洁 黄鑫 汤彦甫 冯瑶箐

负责人：黄鑫、孙雪洁				门		配件柜	溶剂柜	负责人：王金雷、冯瑶箐		
顶柜	桌面	抽屉	底柜					桌面	抽屉	柜子
移液枪头	荧光光度计	螺旋测微仪、单轴拉伸机	荧光光度计配件、接触角配件、冷冻离心机配件	柜子	抽屉	抽屉	柜子	提拉机	水槽	
		公用电线 双面胶 剪刀		CY	TYF	HX	HX	细胞粉碎机	PF	
擦拭纸 口罩	接触角测量仪		橡胶管	过道	LXJ	FYQ	标签纸	摩擦机		
		SHZ			FYQ	PF	SXJ	冷冻离心机		
				负责人：汤彦甫						
气瓶柜		大热压机	烘箱	离心机	热压机	熔融拉丝机	烘箱	光源柜		
				耗材柜						

房间号：723 负责人：刘晓珺 姜黎新 彭博 崔淑贞

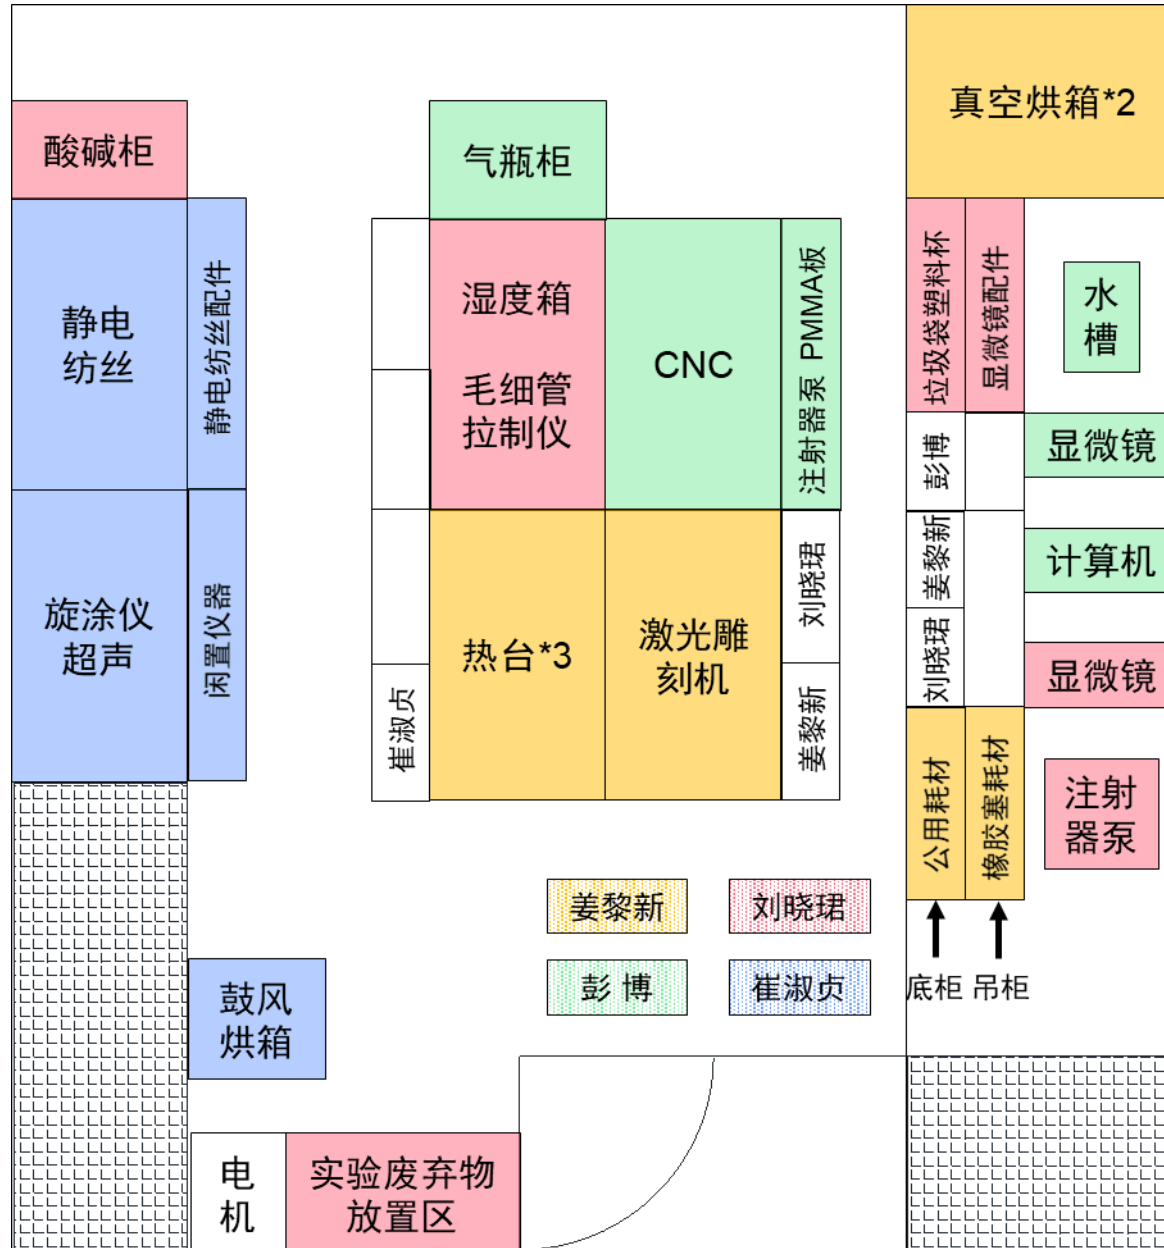

房间号：726 负责人：鲁遥

726实验室布局

